

お客様各位

2025年1月吉日  
ジーエルサイエンス株式会社

## DigiTUBE 50 mL 製品の仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、皆様にご愛用いただいております DigiTUBE 50 mL 製品につきまして、Analytichem Canada 社より外観と全容量ラインの ClassA 保証について変更の連絡がありましたので、以下の通りにご案内させていただきます。

本件に関するお問い合わせは、弊社営業担当者までお願いいたします。  
何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### － 記 －


#### 【対象製品】

50 mL RackLock DigiTUBEs 及び 50 mL Non RackLock DigiTUBEs


#### 【変更箇所】

- ① チューブに「analytichem」、「DigiTUBE」と表示されます。
- ② 40 mL 目盛に、「40」の表記が追加されます。
- ③ 全ての目盛が ClassA 保証となります。


## 【外観】

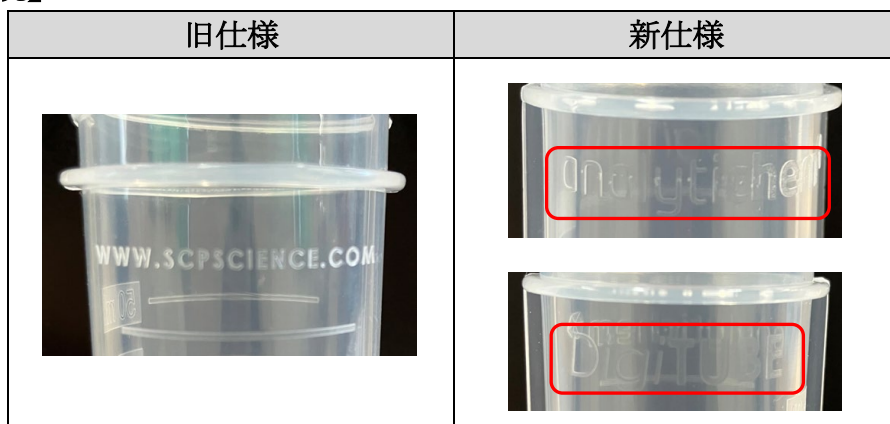

## RackLock DigiTUBE

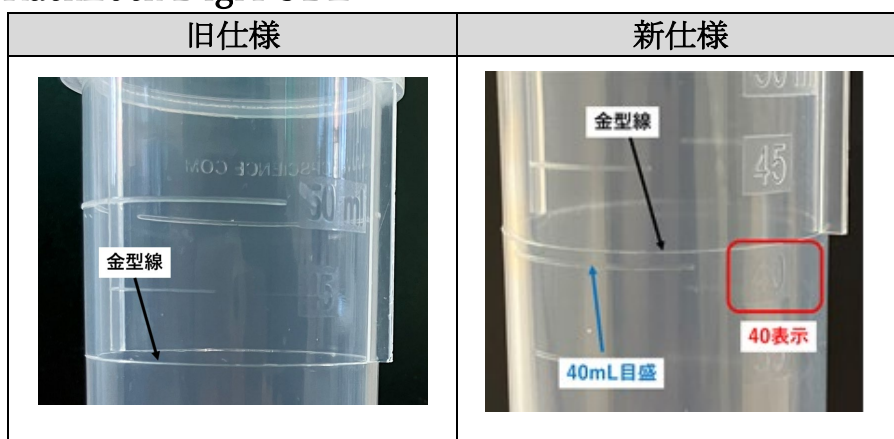

## Non RackLock DigiTUBE

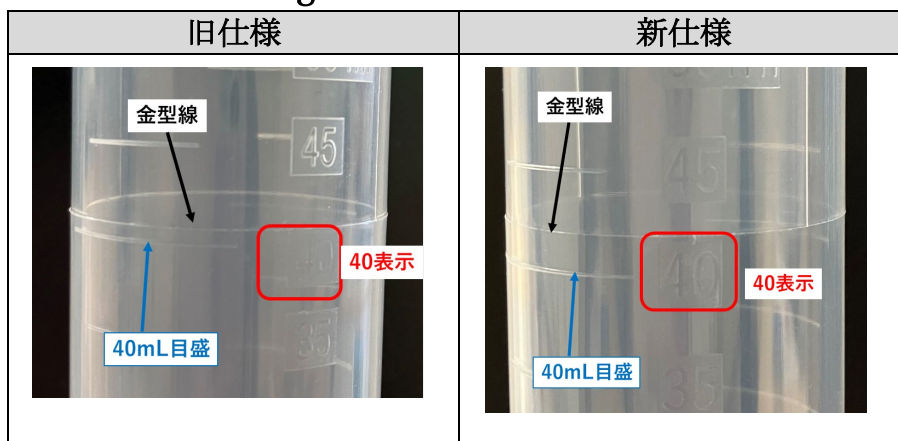

## 【補足】

- 使用方法やその他性能に対する変更はございません。
- 40 mL 目盛ライン付近に見られる1周線は容量の目盛線ではありません。  
製造時にできる金型の線ですので、お間違えの無いようご注意ください。

以上