
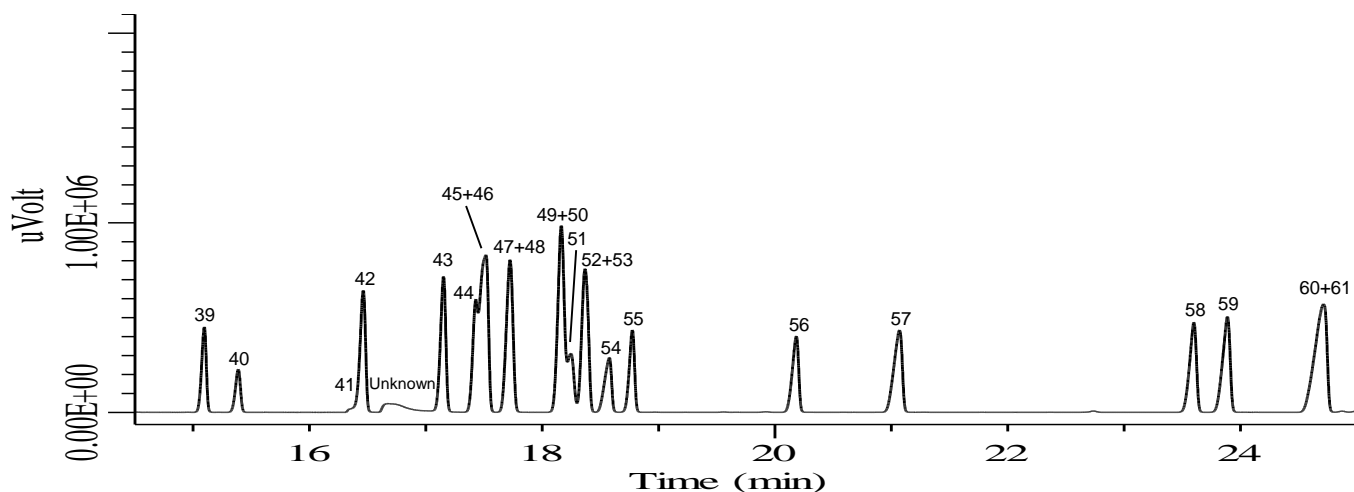


保持指標とは、直鎖アルカンの炭素数を基準とし、直鎖アルカンと対象成分の保持比を相対的に表した指標であり、定性分析に非常に有効な情報の一つとなります。

恒温分析では直鎖アルカンの保持比の対数が、昇温分析では直鎖アルカンの保持比が直鎖アルカンの炭素数と直線関係があることから、保持指標を求めることができます。

今回はInertCap 1を使用して、キャリアガスに窒素を用いた場合の有機溶剤61成分の昇温分析及び恒温分析での保持指標を求めましたので、ご紹介致します。

## 標準液測定例

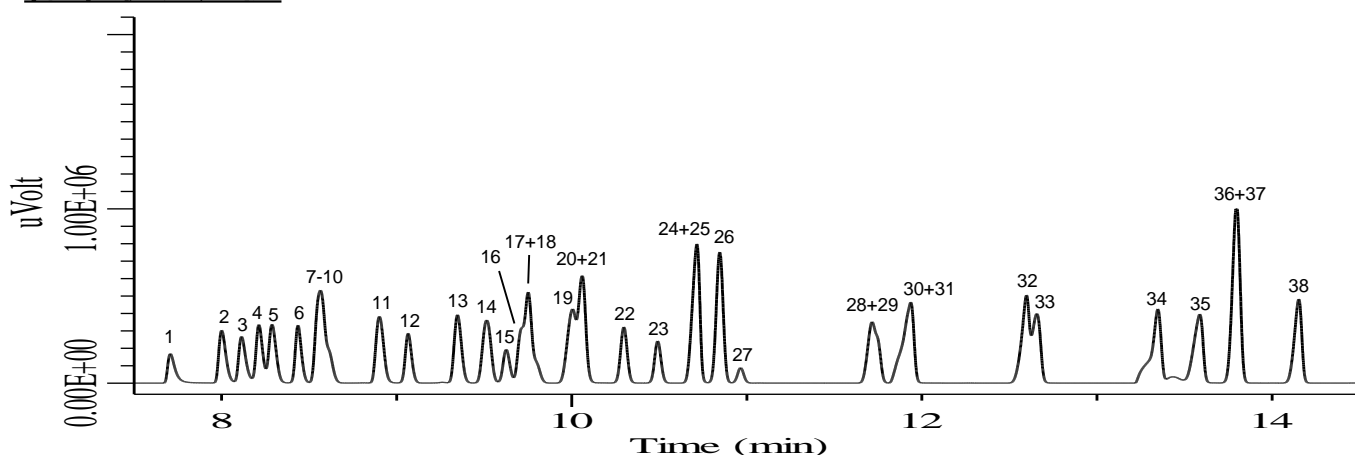

### Conditions

<b>System</b>	: GC-FID
<b>Column</b>	: InertCap 1 0.25 mm I.D. × 60 m df = 0.25 μm
<b>Col. Temp.</b>	: 40 °C - 5 °C/min - 220 °C
<b>Carrier Gas</b>	: N <sub>2</sub> 90 kPa
<b>Injection</b>	: Split 1:50 240 °C
<b>Detection</b>	: FID Range 10 <sup>10</sup> 240 °C
<b>Sample Size</b>	: Mixed evenly 0.2 μL

上記クロマト条件。

恒温分析条件は、線速度が一定になるように圧力を調節。

昇温分析における保持指標

ピークNo.	ピーク名	保持指標	保持時間	ピークNo.	ピーク名	保持指標	保持時間
1	Methanol	397	7.674	32	3-Methyl-1-butanol (Isoamyl alcohol)	717	12.567
2	Ethanol	405	7.965	33	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	719	12.634
3	Acetonitrile	428	8.084	34	<i>N,N</i> -Dimethylformamide	739	13.268
4	Acetone	448	8.183	35	1-Pentanol(Amyl alcohol)	747	13.546
5	2-Propanol (Isopropyl alcohol)	462	8.257	36	Isobutyl acetate	754	13.761
6	Ethyl ether	492	8.409	37	Toluene	755	13.782
7	Carbon disulfide	509	8.568	38	2-Hexanone(MBK)	766	14.134
8	<i>tert</i> -Butanol	506	8.528	39	<i>n</i> -Butyl acetate	795	15.071
9	Methyl acetate	508	8.554	40	Tetrachloroethylene	803	15.359
10	Dichloromethane	511	8.596	41	<i>N,N</i> -Dimethylacetamide	829	16.308
11	1-Propanol	533	8.878	42	Chlorobenzene	832	16.441
12	<i>trans</i> -1,2-Dichloroethylene	546	9.045	43	Ethylbenzene	851	17.128
13	Methyl ethyl ketone	568	9.327	44	Isopentyl acetate (Isoamyl acetate)	858	17.381
14	2-Butanol	580	9.491	45	<i>m</i> -Xylene	859	17.448
15	<i>cis</i> -1,2-Dichloroethylene	589	9.602	46	<i>p</i> -Xylene	860	17.488
16	Ethyl acetate	596	9.697	47	Cyclohexanone	866	17.682
17	<i>n</i> -Hexane	600	9.746	48	Cyclohexanol	866	17.682
18	Chloroform	602	9.786	49	2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve acetate)	877	18.12
19	2-Methyl-1-propanol (Isobutyl alcohol)	610	9.975	50	Styrene	878	18.125
20	Tetrahydrofuran	613	10.037	51	1-Methylcyclohexanol	879	18.177
21	2-Methoxyethanol (Methyl cellosolve)	614	10.060	52	1,1,1,2-Tetrachloroethane	881	18.269
22	1,2-Dichloroethane	623	10.281	53	<i>o</i> -Xylene	883	18.332
23	1,1,1-Trichloroethane	632	10.478	54	2-Butoxyethanol (Butyl cellosolve)	888	18.528
24	Isopropyl acetate	641	10.683	55	<i>n</i> -Pentyl acetate	894	18.742
25	1-Butanol	642	10.705	56	4-Methylcyclohexanone	931	20.171
26	Benzene	654	10.975	57	Phenol	953	21.037
27	Carbon tetrachloride	653	10.948	58	1,2-Dichlorobenzene	1018	23.582
28	1,4-Dioxane	685	11.684	59	<i>o</i> -Cresol	1025	23.868
29	Trichloroethylene	687	11.723	60	<i>p</i> -Cresol	1048	24.752
30	2-Ethoxyethanol (Cellosolve)	693	11.877	61	<i>m</i> -Cresol	1049	24.791
31	<i>n</i> -Propyl acetate	695	11.915				

※保持時間の単位:分

※シンメトリー係数が1.5以上の成分は赤字にしています。

昇温分析の場合・・・

直鎖アルカンの保持比と直鎖アルカンの炭素数が直線関係にあるので、保持指標は以下の式で表される。

$$\text{保持指標 } I = 100 \times \frac{t_R - t_{R(Z)}}{t_{R(Z+1)} - t_{R(Z)}} + 100 \times Z$$


$t_R$  =対象成分の保持時間

$t_{R(Z)}$  =対象成分の前に出てくる直鎖アルカンの保持時間

$t_{R(Z+1)}$  =対象成分の後に出てくる直鎖アルカンの保持時間

$Z$  =保持時間 $t_{R(Z)}$ の直鎖アルカンの炭素数

直鎖アルカン(Z)

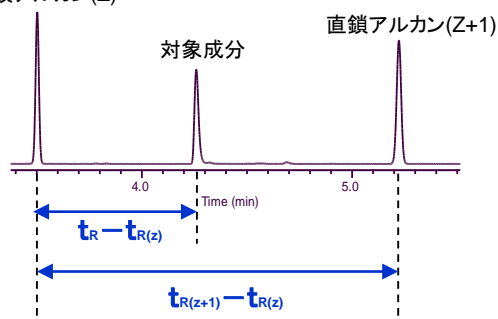

恒温分析における保持指標－1

昇温時の ピーク順序	ピーク名	40℃		80℃		120℃		160℃	
		保持指標	保持時間	保持指標	保持時間	保持指標	保持時間	保持指標	保持時間
1	Methanol	378	7.619	354	7.195	317	7.745	387	7.502
2	Ethanol	448	8.037	418	7.318	415	7.815	447	7.539
3	Acetonitrile	460	8.141	445	7.383	447	7.850	476	7.563
4	Acetone	480	8.333	461	7.428	457	7.862	485	7.572
5	2-Propanol (Isopropyl alcohol)	491	8.462	468	7.449	461	7.867	484	7.571
6	Ethyl ether	509	8.695	491	7.529	489	7.909	498	7.585
7	Carbon disulfide	509	8.687	491	7.529	491	7.912	493	7.580
8	tert-Butanol	520	8.869	503	7.577	506	7.937	515	7.600
9	Methyl acetate	524	8.930	507	7.592	508	7.941	513	7.598
10	Dichloromethane	526	8.967	515	7.627	519	7.962	534	7.617
11	1-Propanol	552	9.496	534	7.720	527	7.977	541	7.624
12	trans-1,2-Dichloroethylene	562	9.725	555	7.838	556	8.043	575	7.661
13	Methyl ethyl ketone	581	10.249	572	7.953	571	8.081	588	7.677
14	2-Butanol	592	10.585	580	8.008	582	8.112	590	7.680
15	cis-1,2-Dichloroethylene	597	10.756	593	8.105	594	8.149	613	7.710
16	Ethyl acetate	604	11.021	592	8.097	587	8.128	592	7.683
17	n-Hexane	606	11.067	598	8.152	598	8.162	608	7.703
18	Chloroform	606	11.092	602	8.188	610	8.200	622	7.723
19	2-Methyl-1-propanol (Isobutyl alcohol)	620	11.633	606	8.220	602	8.175	613	7.711
20	Tetrahydrofuran	619	11.589	617	8.323	624	8.249	640	7.751
21	2-Methoxyethanol (Methyl cellosolve)	620	11.633	613	8.283	615	8.218	629	7.733
22	1,2-Dichloroethane	630	12.099	630	8.455	638	8.301	654	7.773
23	1,1,1-Trichloroethane	634	12.277	640	8.567	650	8.348	666	7.794
24	Isopropyl acetate	649	13.063	642	8.584	636	8.291	644	7.756
25	1-Butanol	649	13.069	642	8.580	638	8.302	645	7.759
26	Benzene	649	13.061	657	8.766	666	8.423	684	7.828
27	Carbon tetrachloride	655	13.371	662	8.838	673	8.452	690	7.840
28	1,4-Dioxane	685	15.442	689	9.233	695	8.567	711	7.883
29	Trichloroethylene	686	15.488	692	9.280	699	8.594	716	7.894
30	2-Ethoxyethanol (Cellosolve)	694	16.187	693	9.298	691	8.548	704	7.868
31	n-Propyl acetate	699	16.563	693	9.302	689	8.536	696	7.851

※保持時間の単位:分

※シンメトリー係数が1.5以上の成分は赤字にしています。

恒温分析の場合・・・

直鎖アルカンの保持比の対数と直鎖アルカンの炭素数が直線関係にあるので、保持指標は以下の式で表される。

$$\text{保持指標 } I = 100 \times \frac{\log t'_R - \log t'_{R(Z)}}{\log t'_{R(Z+1)} - \log t'_{R(Z)}} + 100 \times Z$$

$t_R$  =対象成分の保持時間

$t_{R(Z)}$  =対象成分の前に出てくる直鎖アルカンの保持時間

$t_{R(Z+1)}$  =対象成分の後に出てくる直鎖アルカンの保持時間

Z =保持時間 $t_{R(Z)}$ の直鎖アルカンの炭素数

$t'_R$  =補正保持時間  $t'_R = t_R - t_0$

$t_0$  =ホールドアップタイム(非保持成分の溶出時間)

## 恒温分析における保持指標－2

昇温時の ピーク順序	ピーク名	40°C		80°C		120°C		160°C	
		保持指標	保持時間	保持指標	保持時間	保持指標	保持時間	保持指標	保持時間
32	3-Methyl-1-butanol (Isoamyl alcohol)	722	18.851	715	9.712	713	8.673	722	7.908
33	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	721	18.697	721	9.827	725	8.748	736	7.941
34	<i>N,N</i> -Dimethylformamide	739	20.861	742	10.301	748	8.905	765	8.019
35	1-Pentanol(Amyl alcohol)	754	22.924	747	10.423	745	8.884	752	7.983
36	Isobutyl acetate	760	23.753	755	10.623	753	8.946	758	8.000
37	Toluene	752	22.648	760	10.790	771	9.091	787	8.084
38	2-Hexanone(MBK)	768	25.064	768	10.988	769	9.077	781	8.067
39	<i>n</i> -Butyl acetate	799	31.041	794	11.813	789	9.259	795	8.111
40	Tetrachloroethylene	795	30.203	806	12.255	819	9.562	836	8.259
41	<i>N,N</i> -Dimethylacetamide	827	38.136	830	13.123	838	9.787	851	8.318
42	Chlorobenzene	823	36.940	834	13.332	849	9.931	867	8.388
43	Ethylbenzene	843	43.012	852	14.222	864	10.140	878	8.442
44	Isopentyl acetate (Isoamyl acetate)	862	49.713	858	14.520	856	10.028	859	8.352
45	<i>m</i> -Xylene	852	45.945	861	14.677	870	10.234	882	8.463
46	<i>p</i> -Xylene	853	46.363	862	14.732	871	10.242	885	8.478
47	Cyclohexanone	854	46.568	866	15.008	882	10.421	902	8.562
48	Cyclohexanol	860	49.053	866	14.958	875	10.309	890	8.501
49	2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve acetate)	886	60.426	878	15.695	871	10.253	871	8.408
50	Styrene	868	52.032	878	15.709	889	10.542	905	8.578
51	1-Methylcyclohexanol	870	52.877	879	15.772	890	10.559	908	8.597
52	1,1,2,2-Tetrachloroethane	873	54.268	881	15.920	892	10.589	910	8.607
53	<i>o</i> -Xylene	872	53.872	883	16.058	895	10.648	912	8.617
54	2-Butoxyethanol (Butyl cellosolve)	887	61.049	888	16.368	890	10.554	897	8.537
55	<i>n</i> -Pentyl acetate	899	66.827	894	16.809	891	10.570	891	8.504
56	4-Methylcyclohexanone	—	—	928	19.542	945	11.648	967	8.966
57	Phenol	—	—	955	22.227	946	11.681	948	8.841
58	1,2-Dichlorobenzene	—	—	1013	30.331	1031	14.255	1052	9.724
59	<i>o</i> -Cresol	—	—	1028	33.057	1024	14.001	1031	9.509
60	<i>p</i> -Cresol	—	—	1049	37.332	1044	14.762	1047	9.665
61	<i>m</i> -Cresol	—	—	1050	37.593	1045	14.808	1047	9.672

※保持時間の単位：分

※シンメトリー係数が1.5以上の成分は赤字にしています。



ジーエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー 30F  
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622

※各試験法は、変更される場合がありますので、分析の前に確認されることをお勧めします。

データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任をおうものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

カスタマーサポートセンターでは、ノウハウのご提供と分析に関するフォローを行なっております。お困りの際は、カスタマーサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

カスタマーサポートセンター (土・日・祝除く9:00-17:00)

☎ 04-2934-1100 ✉ info@gl.s.co.jp



【アプリケーションの検索はこちら】

[https://www.gl.s.co.jp/technique/app/app\\_search.html](https://www.gl.s.co.jp/technique/app/app_search.html)